


Carlevale™

REF. : ISP60VL

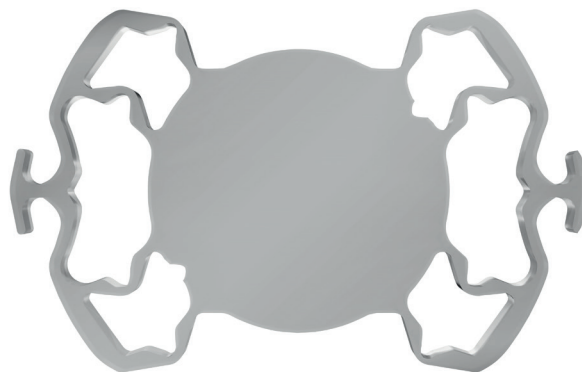

→ Caractéristiques techniques

TYPE	Monofocal - Non préchargé Kit injecteur fourni
MATÉRIAU	Hybride : hydrophile / hydrophobe Copolymère HEMA / EOEMA ultra-purifié Filtre UV et filtre de lumière bleue Natural Yellow™
DESIGN	Monobloc Bords carrés à 360°
OPTIQUE	Biconvexe / Asphérique
ASPHÉRICITÉ	-0.26 μm
TAILLE D'INCISION RECOMMANDÉE	2.2 mm
DIAMÈTRE OPTIQUE / DIAMÈTRE TOTAL	6.5 mm / 13.4 mm
ANGULATION	10°
INDICE DE RÉFRACTION	1.46
PUISSANCE (DIOPTRIE)	- 5.0 D à + 10.0 D par pas de 1.0 D + 10.5 D à + 31.5 D par pas de 0.5 D + 32.0 D à + 40.0 D par pas de 1.0 D
CONSTANTE A	Ultrasonique : 118.0

CONSTANTES (FABRICANT)


HAIGIS	$a_0 = 1.589 / a_1 = 0.400 / a_2 = 0.100$				
HOFFER Q	pACD = 5.20	HOLL.	sf = 1.42	HOLL.2	5.257
BARRETT	LF = 1.62	SRK/T	A = 118.50	SRK II	A = 118.7

L'IMPLANT INTRAOCULAIRE CARLEVALE™ EST UN DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIB (FABRICANT OMNI LENS PUT LTD / CE 2460) FOURNI AVEC UN INJECTEUR (FABRICANT MEDICEL AG / CE 0482) SOUS FORME D'UN KIT (ASSEMBLÉ PAR MD-TECH).
DISTRIBUTEUR : OPHTHA-FRANCE. CES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ.
POUR UN BON USAGE DU PRODUIT, MERCI DE VOUS REPORTER À LA NOTICE DU PRODUIT.

→ Schémas techniques

DIAMÈTRE OPTIQUE	DIAMÈTRE TOTAL	DIOPTRIE
6.5 mm	13.4 mm	de - 5.0 D à + 40.0 D

LE CARLEVALE™,
VUE DE FACE →

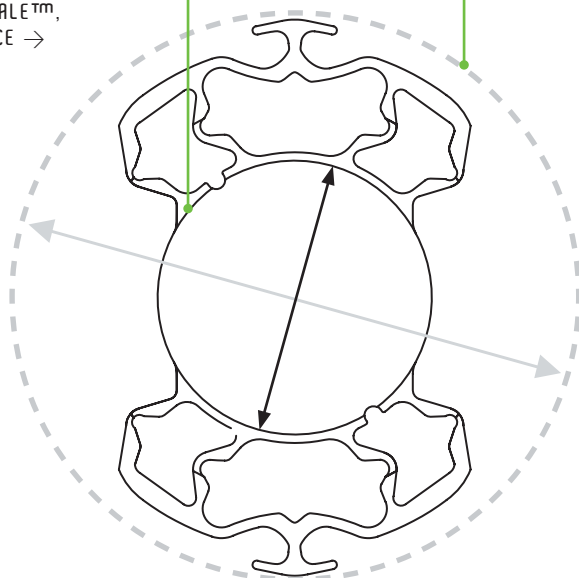

10°



ANGULATION 10°

BORDS CARRÉS À 360°

← LE CARLEVALE™,
VUE EN COUPE

→ Indications

- L'implantation de la **lentille intraoculaire hybride Carlevale™** est indiquée pour la correction de l'aphakie, en absence de support capsulaire.

→ Nouveau design

